MECHA. ASS'Y
(D40-0855-05)

(X14-2520-10)(B/6)

(X14-2520-10)(A/6) SYNTHESIZER UNIT

IC1	: BA3900-V1	IC11,12	: BA4558F				
IC2	: TA8210H						
IC4	: μPD1708AG-822-00						
IC5	: BU4081BF	Q1,2,5,9~11,15,23	: DTC124EK	Q14	: DTC114TK	SIGNAL LINE	
IC6	: CXA1102M	Q3,4	: 2SC2412K(S)	Q21	: 2SB1307M	GND LINE	
IC7	: LA1140-K	Q6,8,16,22,31,32	: 2SC2412K	Q25,26,33,34	: 2SD1757K	+B LINE	
IC8	: LA3370-K	Q7,13	: DTA144EK				
IC10	: M51524L	Q12	: 2SA1037K	D1,3,24,31	: ERA15-01Y1		
				D4~21,25	: RLS-73		
				D22,23	: DAP202K		

2SB1307M



DTA144EK
DTC114TK
DTC124EK
2SA1037K
2SC2412K
2SC2812
2SC2814
2SD1757K
2SC2996

LA1140-K
LA3370-K



BA4558F

BA3900-V1

LA1175



LA1135



CXA1102M



3SK181



2SK715



1708AG-822-00



DC voltages are as measurec voltmeter. Values may vary between individual instruments

F G H I J K L M N O

/6) SYNTHESIZER UNIT

(X14-2520-10)(C/6)

END

DC CORD
E30-2539-05

Q14	:	DTC114TK
Q21	:	2SB1307M
Q25, 26, 33, 34	:	2SD1757K
D1, 3, 24, 31	:	ERA15-01Y1
D4 ~ 21, 25	:	RLS-73
D22, 23	:	DAP202K

SIGNAL LINE
GND LINE
+B LINE

LA1135



CXA1102M



3SK181



2SK715



1708AG-822-00



DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig.

CA
po
to
rec
me
bly
ret

3150

W02-1006-05 FM/AM FRONT-END

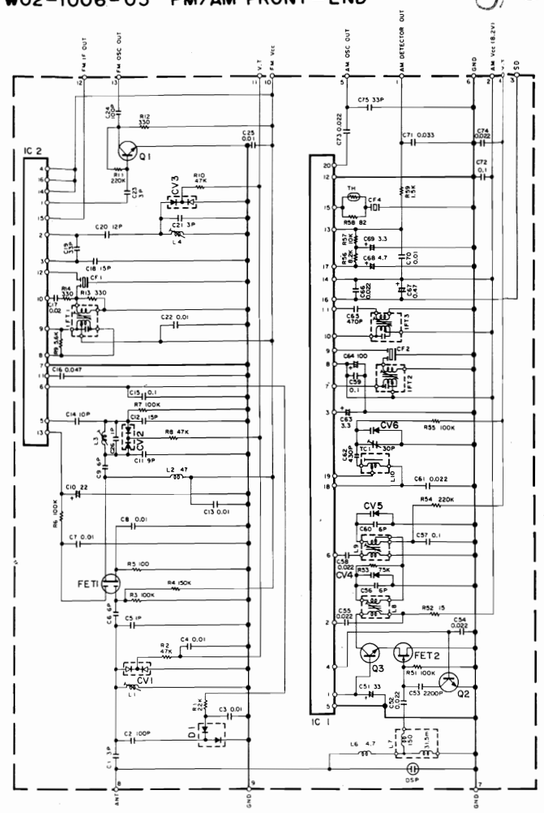

FET 1	3SK 181
FET 2	2SK 715
IC 1	LA1135
IC 2	LA1175
Q 1	2SC2996(O)
Q 2	2SC2814
Q 3	2SC2812



PL1~4 830-1279-05
LCD 838-0117-05

(X25-3520-11) SWITCH UNIT

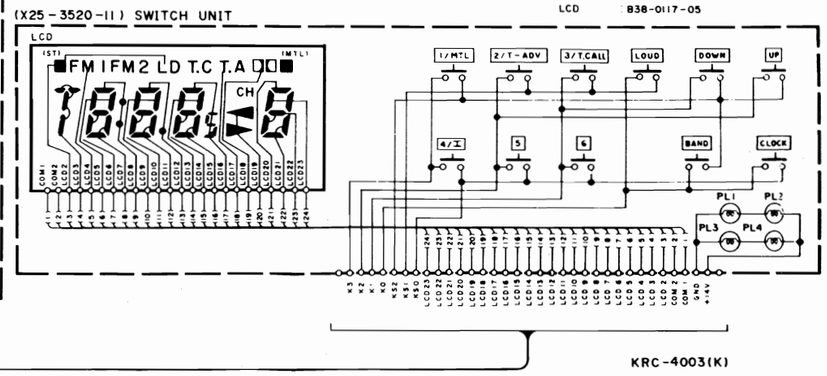

KRC-4003(K)

DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u.U. geringfügig.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

RXB493

KRC-4003

KENWOOD

Y36-1140-10 3150